

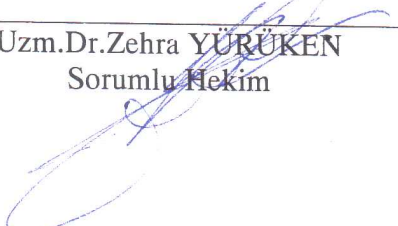




MİKROTÜP SOĞUTUCU BLOK TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	02.10.2017	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Mutlaka 96 well olup PCR plate leri, 0.2/0.1ml single tüpler ve 8/12 li şerit sitriplere birebir uygun olmalıdır.
- 2- Kapaklı olmalı, -20 derecede donmalı , oda sıcaklığında çalışma sırasında 3-6 saat arası çalışabilmelidir.
- 3- Ürün dış ortamda, ısınmaya başladığında uyarıcı mekanizmaya sahip olmalı, renk indikatörü devreye girmelidir.
- 4- Malzemeler yüksek derecede transparent ve yüksek kalite polypropylene'den üretilmiş olmalıdırlar.
- 5- PCR çalışmalarına kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
- 6- Teklifte verilen malzemeler ilgili bölüme ihaleden önce, orjinal paketinde numune verip denettirilmeli, bununla ilgili bölümden onay almalı ve bununla ilgili onay belgesinde teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 7- Çalışmayan ürün yüklenici firma tarafından, en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

Uzm.Dr.Gülşah BİTER Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı 	Uzm.Dr.Gönül ÜNVER ŞEKER Tıbbi Biyokimya Uzmanı 	Uzm.Dr.Zehra YÜRÜKEN Sorumlu Hekim 
--	---	--